



ГРУППА «ОКТАВА-ЭЛЕКТРОНДИЗАЙН»

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА
ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ
общество с ограниченной ответственностью

129281, г.Москва, ул.Енисейская, д.24, кв.150 Тел./Факс: (495) 225-55-01
ОФИС: г.Москва, ул.Годовикова, д.9, территория делового центра «Калибр»,
строение 12, подъезд 12.1, этаж 2

ИНН 7716564530 КПП 771601001
Р/сч. 40702810060020754201 в ПАО «Промсвязьбанк»
К/сч 30101810400000000555 БИК 044525555

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

15 октября 2017 г.

1. Наименование или условное обозначение изделия или продукции: МИ ПКФ-15-018 с Изменением 1. Методика измерения ускорения локальной вибрации, передающейся на руки водителей автомобильных транспортных средств через руль.

2. Перечень документации, представленной на метрологическую экспертизу:

МИ ПКФ-15-018 с Изменением 1	Методика измерения ускорения локальной вибрации, передающейся на руки водителей автомобильных транспортных средств через руль
ПКДУ.411000.001РЭ	Измеритель акустический многофункциональный ЭКОФИЗИКА. Руководство по эксплуатации
ПКДУ.411000.001.02РЭ	Шумомер-вибромметр, анализатор спектра Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации
ПКДУ.411000.001.03РЭ	Вибромметр, анализатор спектра Экофизика-110В. Руководство по эксплуатации
ПКДУ.411000.03 РЭ	Вибромметр, анализатор спектра Экофизика-111В. Руководство по эксплуатации
4277-002-76596538-05РЭ	Измеритель общей и локальной вибрации Октава-101ВМ / Октава-110В. Руководство по эксплуатации

3. Предприятие-разработчик: ООО НПФ «ЭлектронДизайн»

4. Результаты метрологической экспертизы:

4.1. Выбранный метод измерений локальной вибрации идентичен методу, который описан в исходной редакции методики МИ ПКФ-15-018. Вносимые изменения уточняют применяемые в МИ термины и ссылки на нормативные документы, дают более подробное объяснение по обработке результатов измерений при использовании СИ с логарифмической шкалой, что не влияет на показатели точности.

4.2. Вибромметр, анализатор спектра Экофизика-111В, добавленный в МИ, прошёл процедуру утверждения типа СИ в РФ, внесен в реестр СИ. СИ соответствует установленным показателям точности и требованиям МИ. Применение данного СИ в рамках рассматриваемой МИ не приводит изменениям показателей точности.

4.3. Метрологическая терминология, наименования и обозначения величин и их единиц, выражения показателей точности соответствуют нормативной документации в области обеспечения единства измерений.

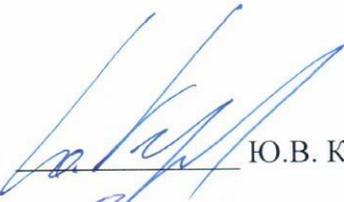
4.4. МИ не предусматривает изменений порядка выполнения измерений, обработки результатов измерений, оценки точности измерений.

5. Выводы и рекомендации

5.1. Вносимые изменения «МИ ПКФ-15-018. Методика измерения ускорения локальной вибрации, передающейся на руки водителей автомобильных транспортных средств через руль» не приводят к изменению показателей точности.

5.2. Повторная аттестация «МИ ПКФ 15-018 с Изменением 1» не требуется.

Руководитель метрологической службы


Ю.В. Куриленко

Инженер-метролог


К.С. Ермачков

